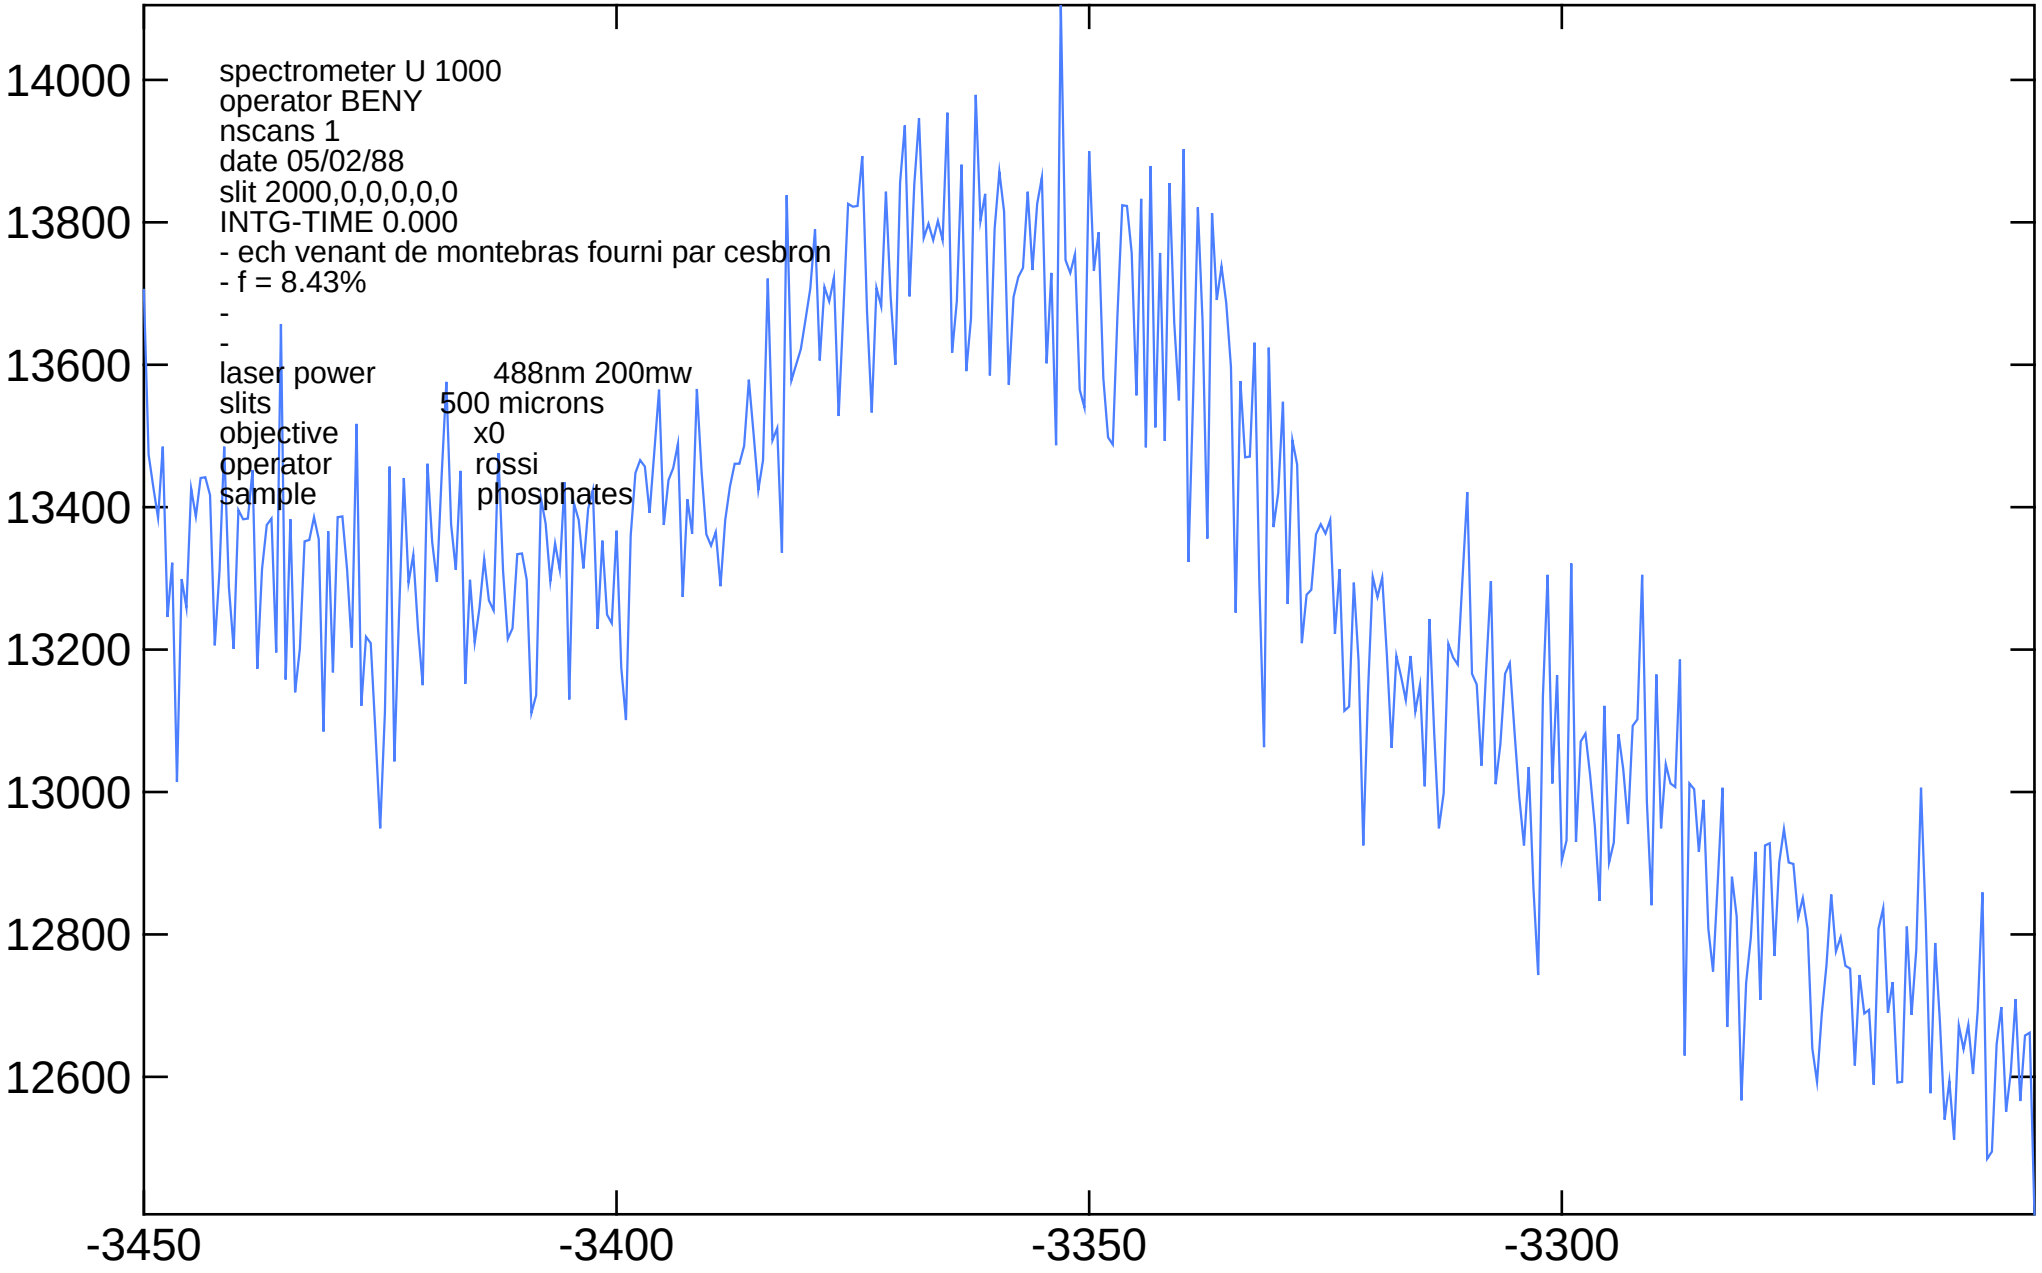
spectrometer U 1000
operator BENY
nscans 1
date 05/02/88
slit 2000,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- ech venant de montebras fourni par cesbron
- f = 8.43%
-
-
laser power 488nm 200mw
slits 500 microns
objective x0
operator rossi
sample phosphates
14000
13800
13600
13400
13200
13000
12800
12600
-3450
-3400
-3350
-3300