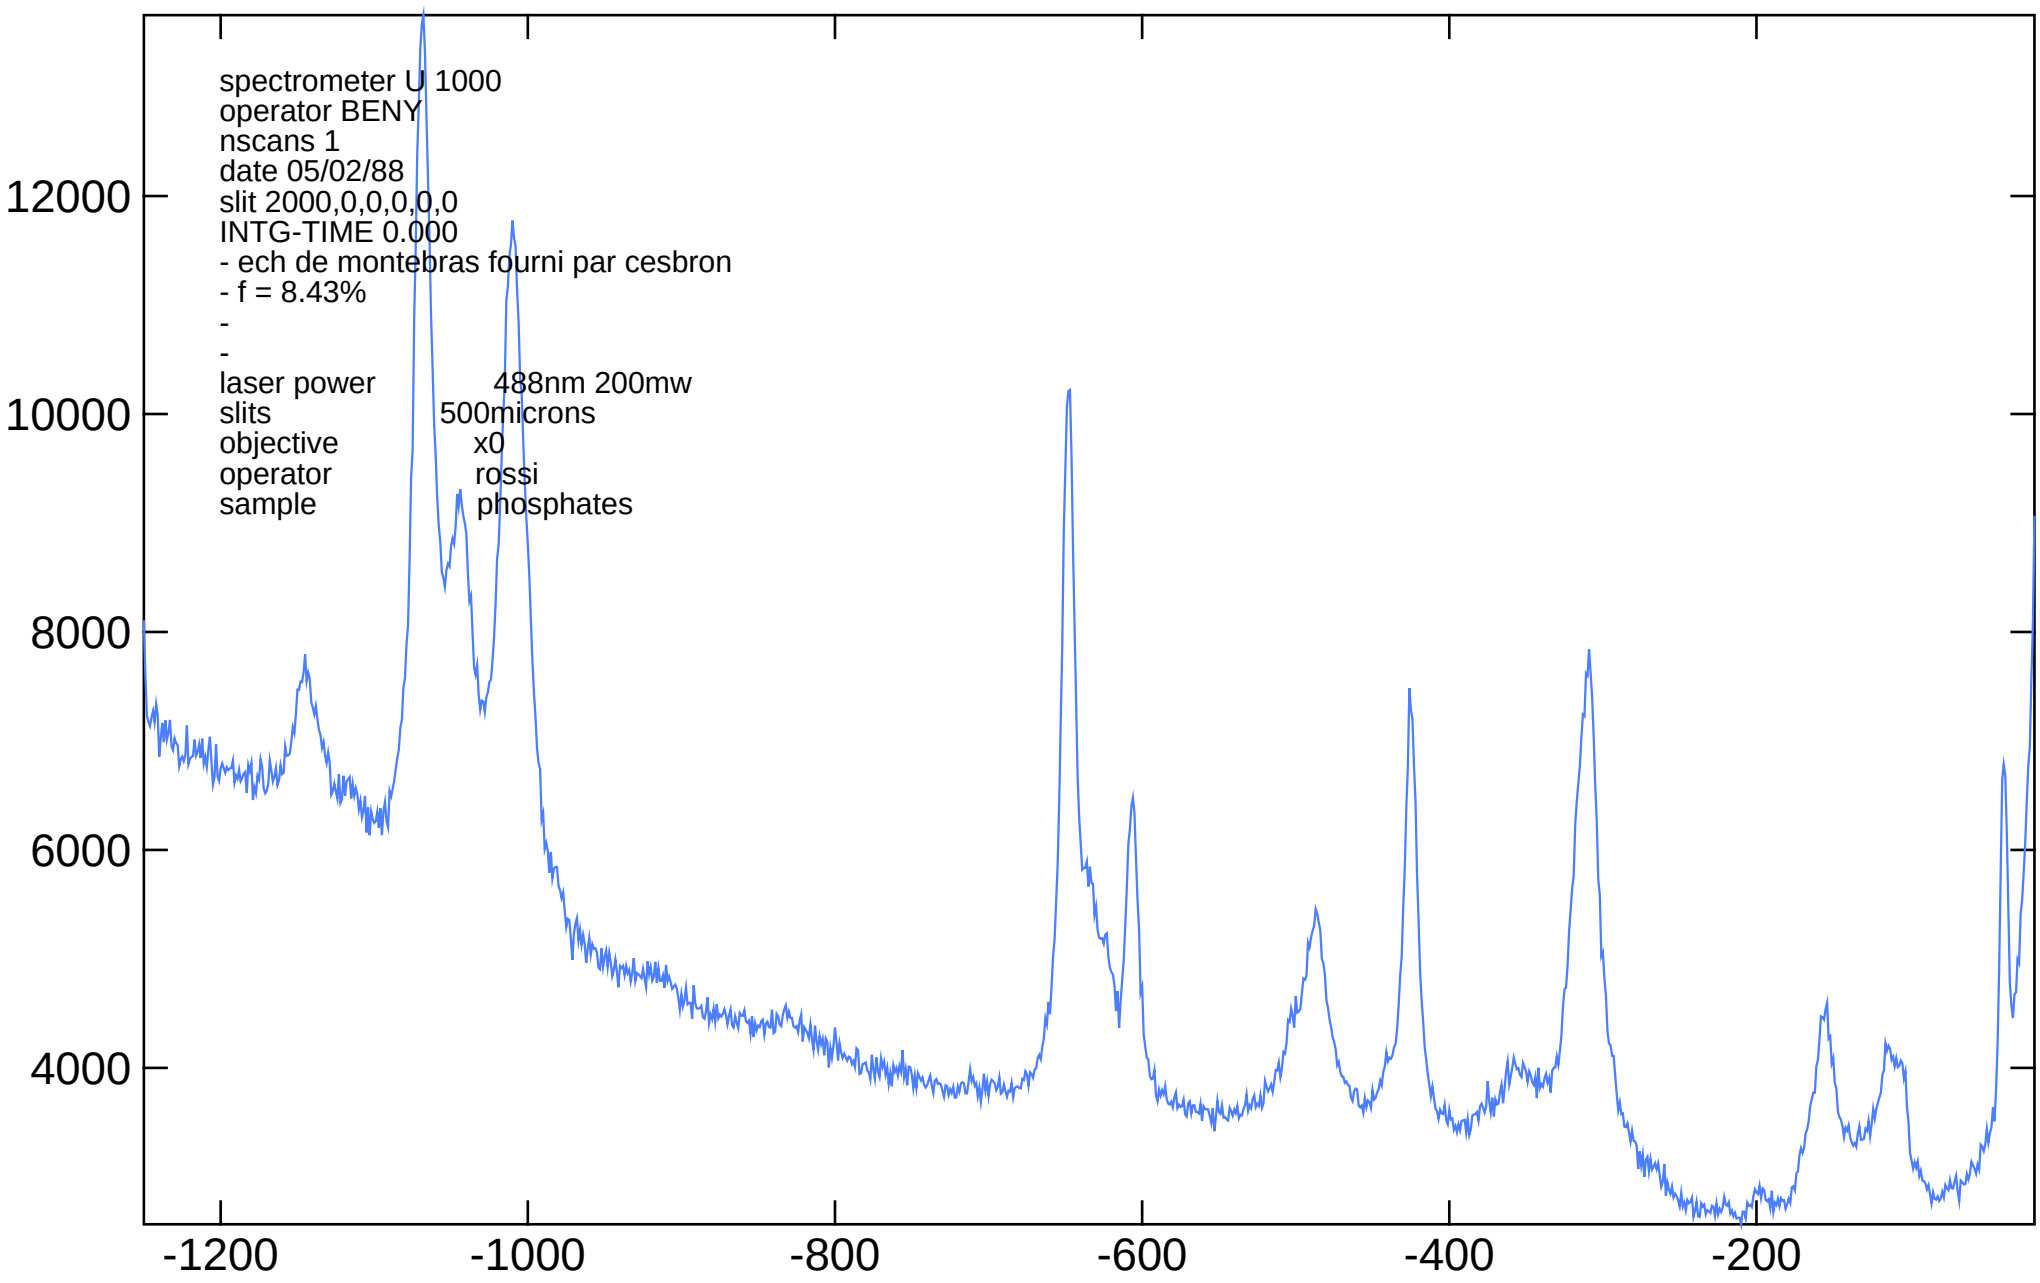
spectrometer U 1000
operator BENY
nscans 1
date 05/02/88
slit 2000,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- ech de montebras fourni par cesbron
- f = 8.43%
-
-
laser power 488nm 200mw
slits 500microns
objective x0
operator rossi
sample phosphates
12000
10000
8000
6000
4000
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200