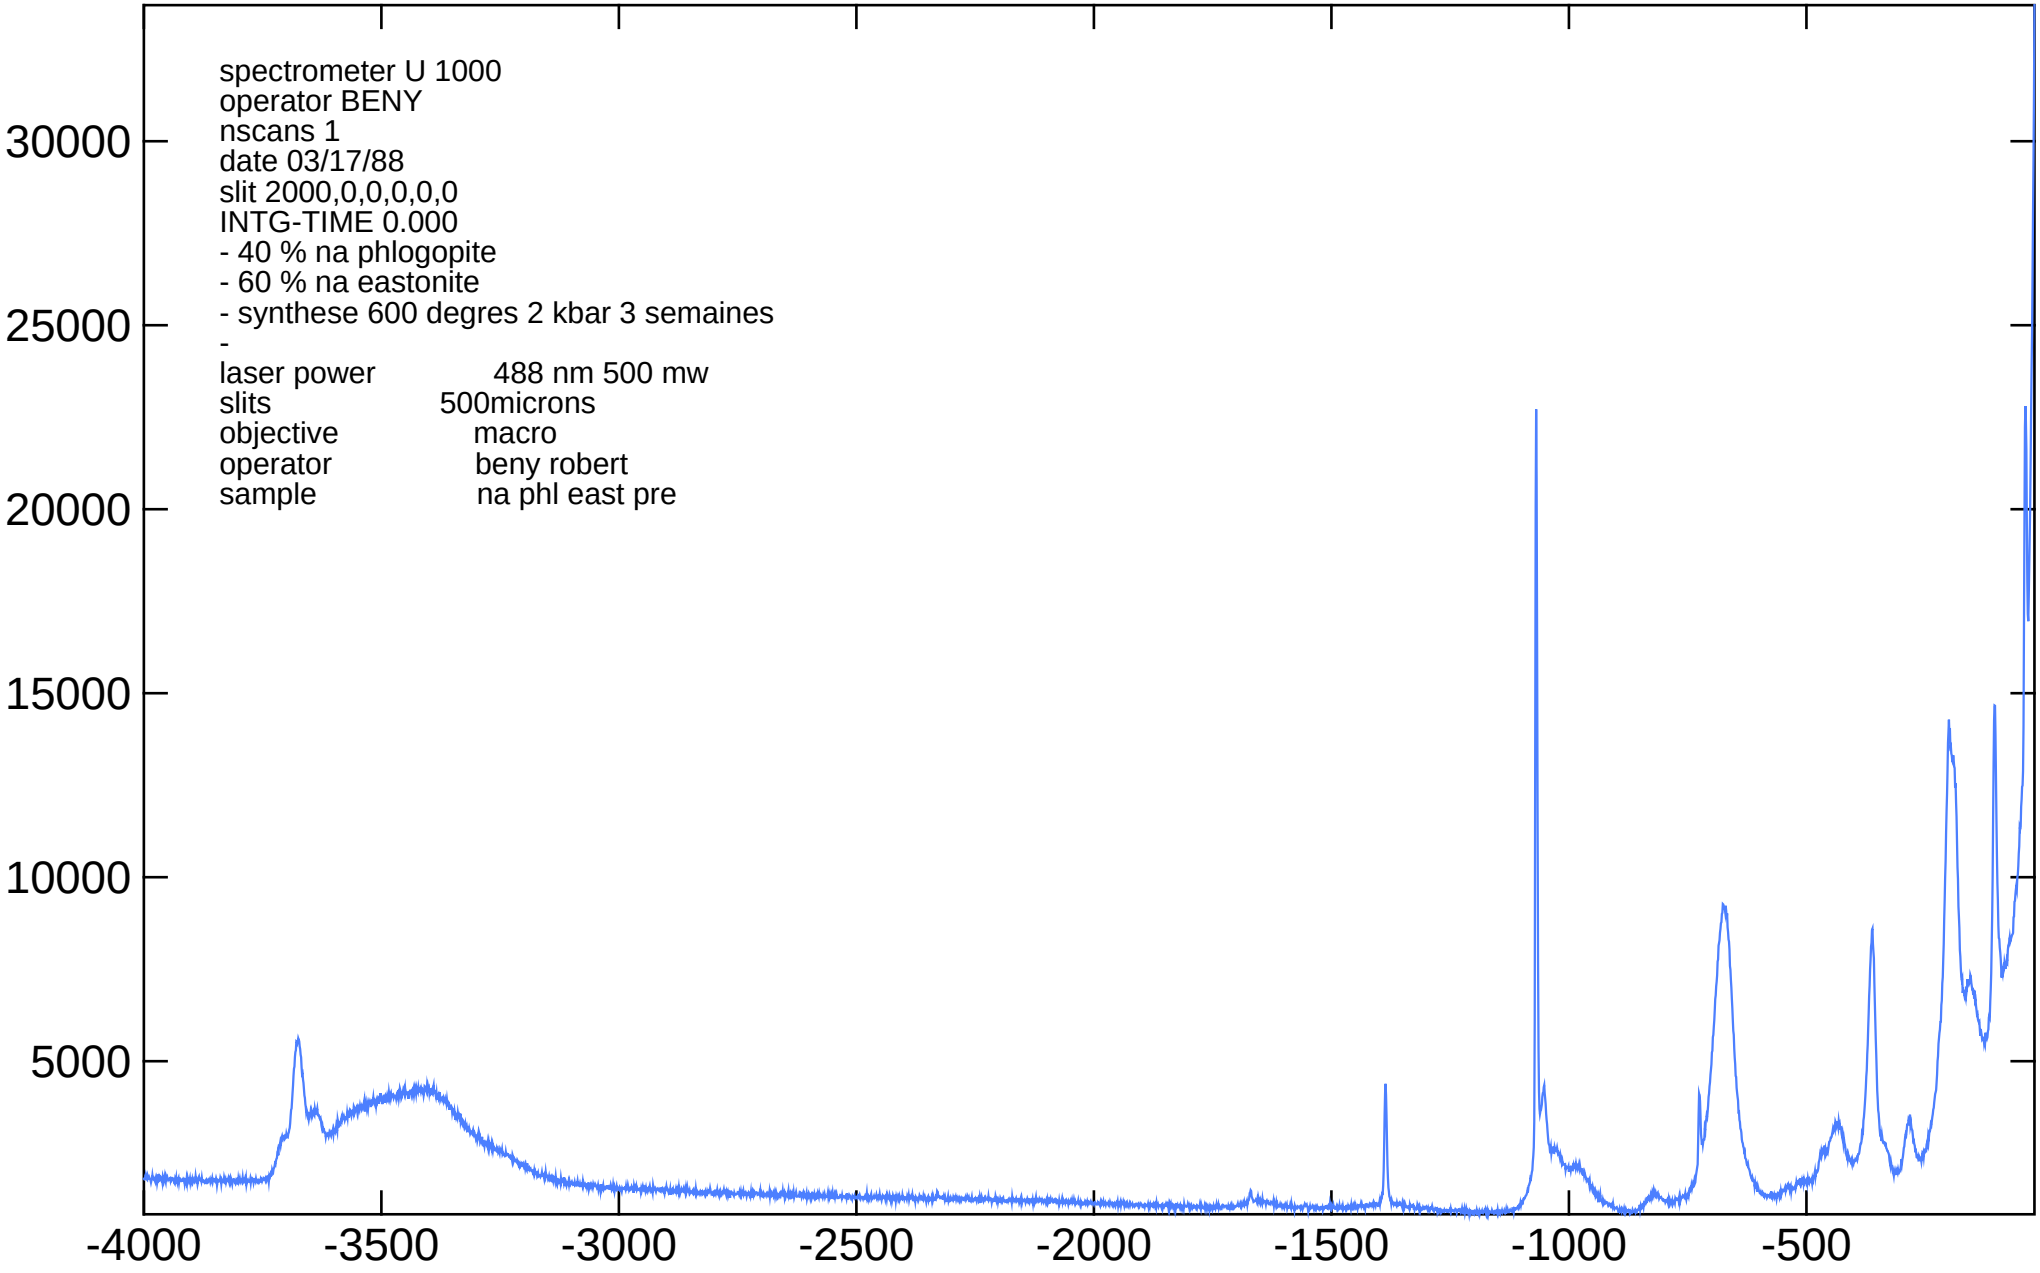
spectrometer U 1000
operator BENY
nscans 1
date 03/17/88
slit 2000,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- 40 % na phlogopite
- 60 % na eastonite
- synthese 600 degres 2 kbar 3 semaines
-
laser power 488 nm 500 mw
slits 500microns
objective macro
operator beny robert
sample na phl east pre
30000
25000
20000
15000
10000
5000
-4000
-3500
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500