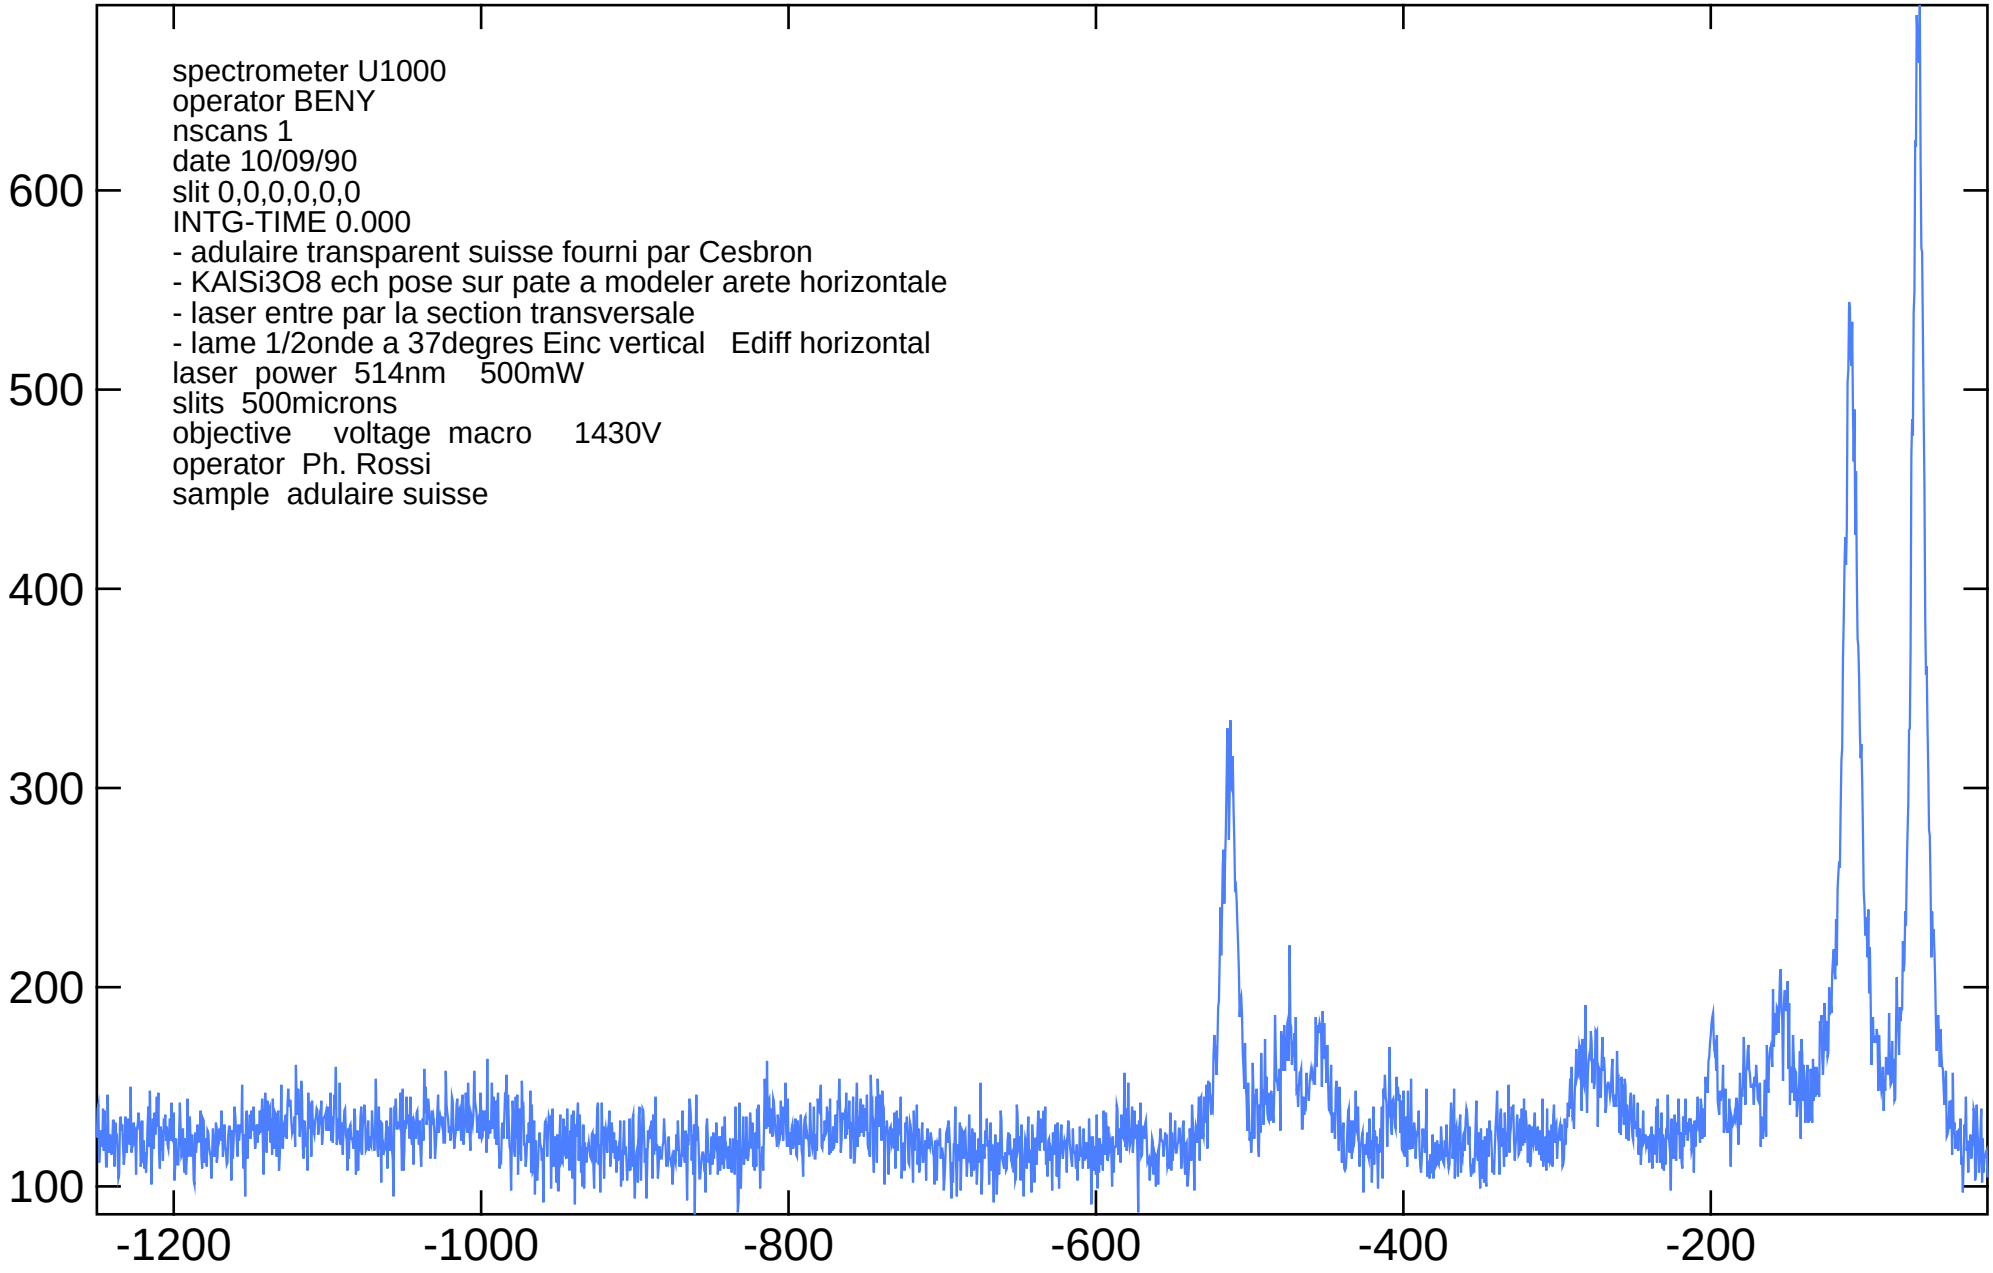
spectrometer U1000
operator BENY
nscans 1
date 10/09/90
slit 0,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- adulaire transparent suisse fourni par Cesbron
- KAlSi3O8 ech pose sur pate a modeler arete horizontale
- laser entre par la section transversale
- lame 1/2onde a 37degres Einc vertical Ediff horizontal
laser power 514nm 500mW
slits 500microns
objective voltage macro 1430V
operator Ph. Rossi
sample adulaire suisse
600
500
400
300
200
100
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200