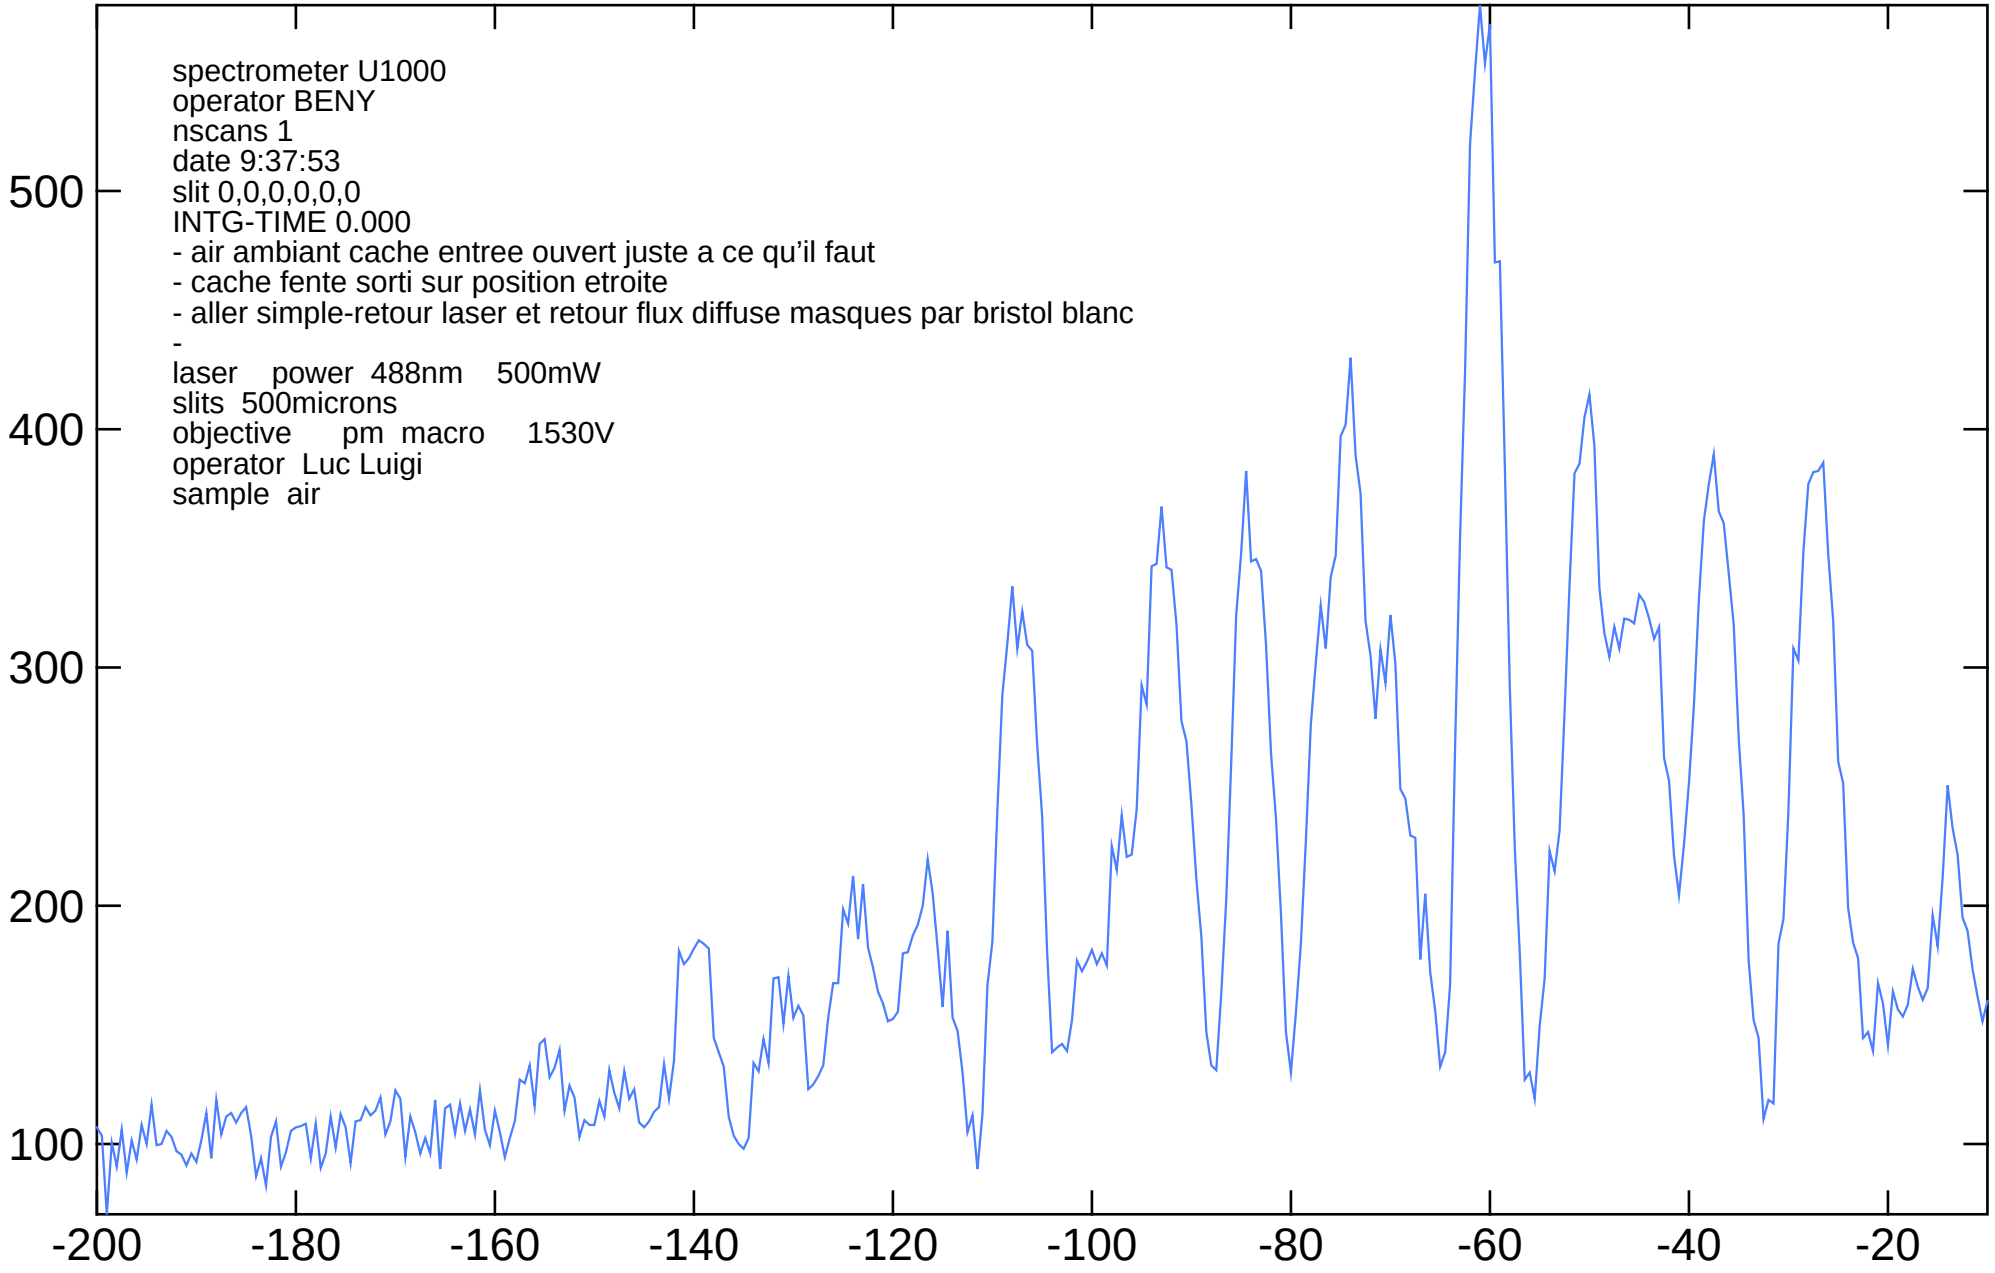
spectrometer U1000
operator BENY
nscans 1
date 9:37:53
slit 0,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- air ambiant cache entree ouvert juste a ce qu'il faut
- cache fente sorti sur position etroite
- aller simple-retour laser et retour flux diffuse masques par bristol blanc
-
laser power 488nm 500mW
slits 500microns
objective pm macro 1530V
operator Luc Luigi
sample air
500
400
300
200
100
-200
-180
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20

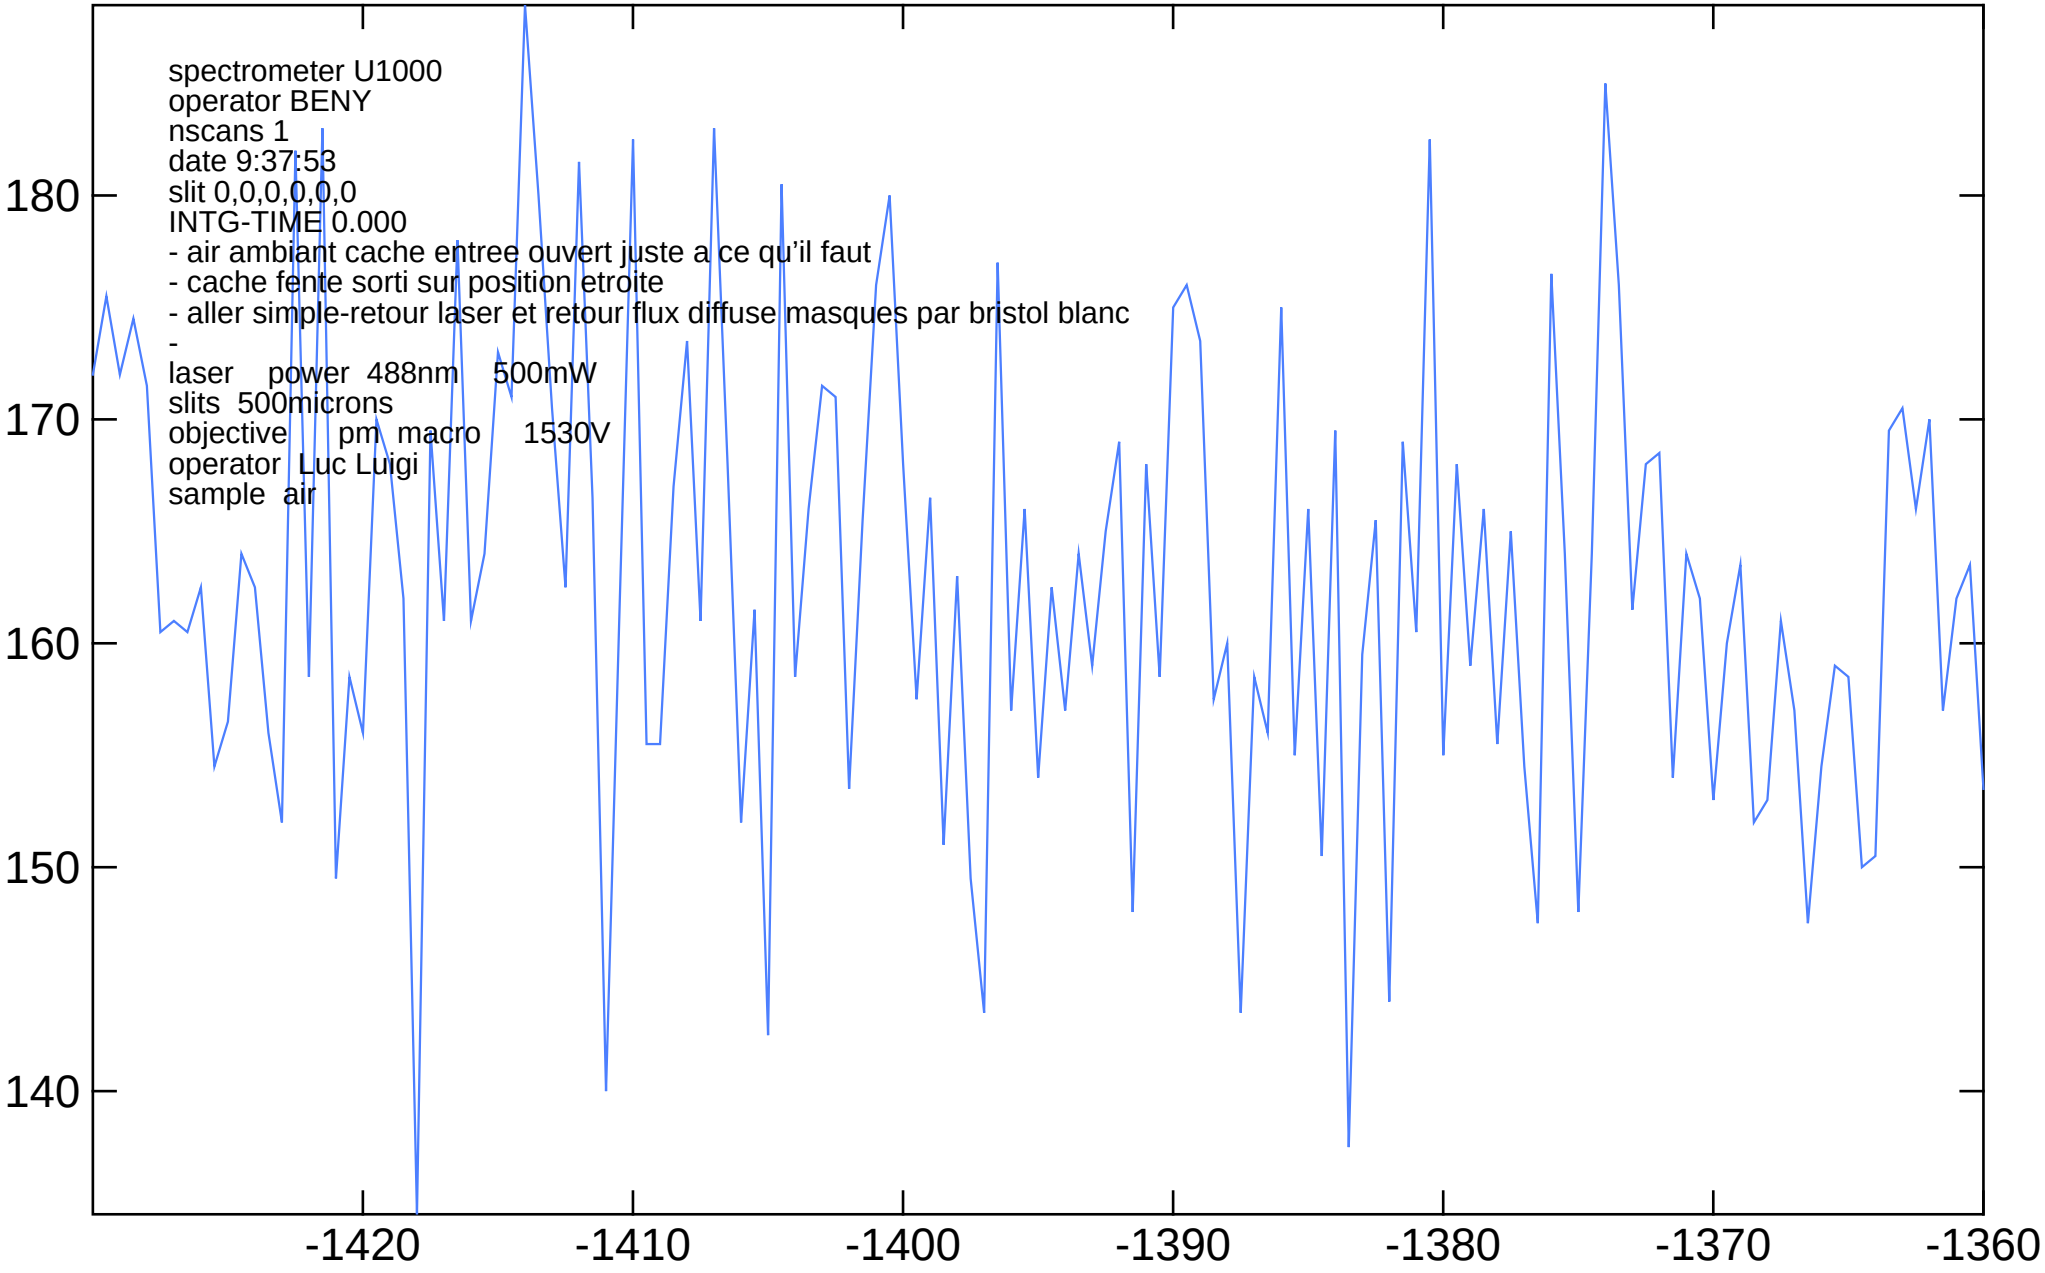
spectrometer U1000
operator BENY
nscans 1
date 9:37:53
slit 0,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- air ambiant cache entree ouvert juste a ce qu'il faut
- cache fente sorti sur position etroite
- aller simple-retour laser et retour flux diffuse masques par bristol blanc
-
laser power 488nm 500mW
slits 500microns
objective pm macro 1530V
operator Luc Luigi
sample air
180
170
160
150
140
-1420
-1410
-1400
-1390
-1380
-1370
-1360

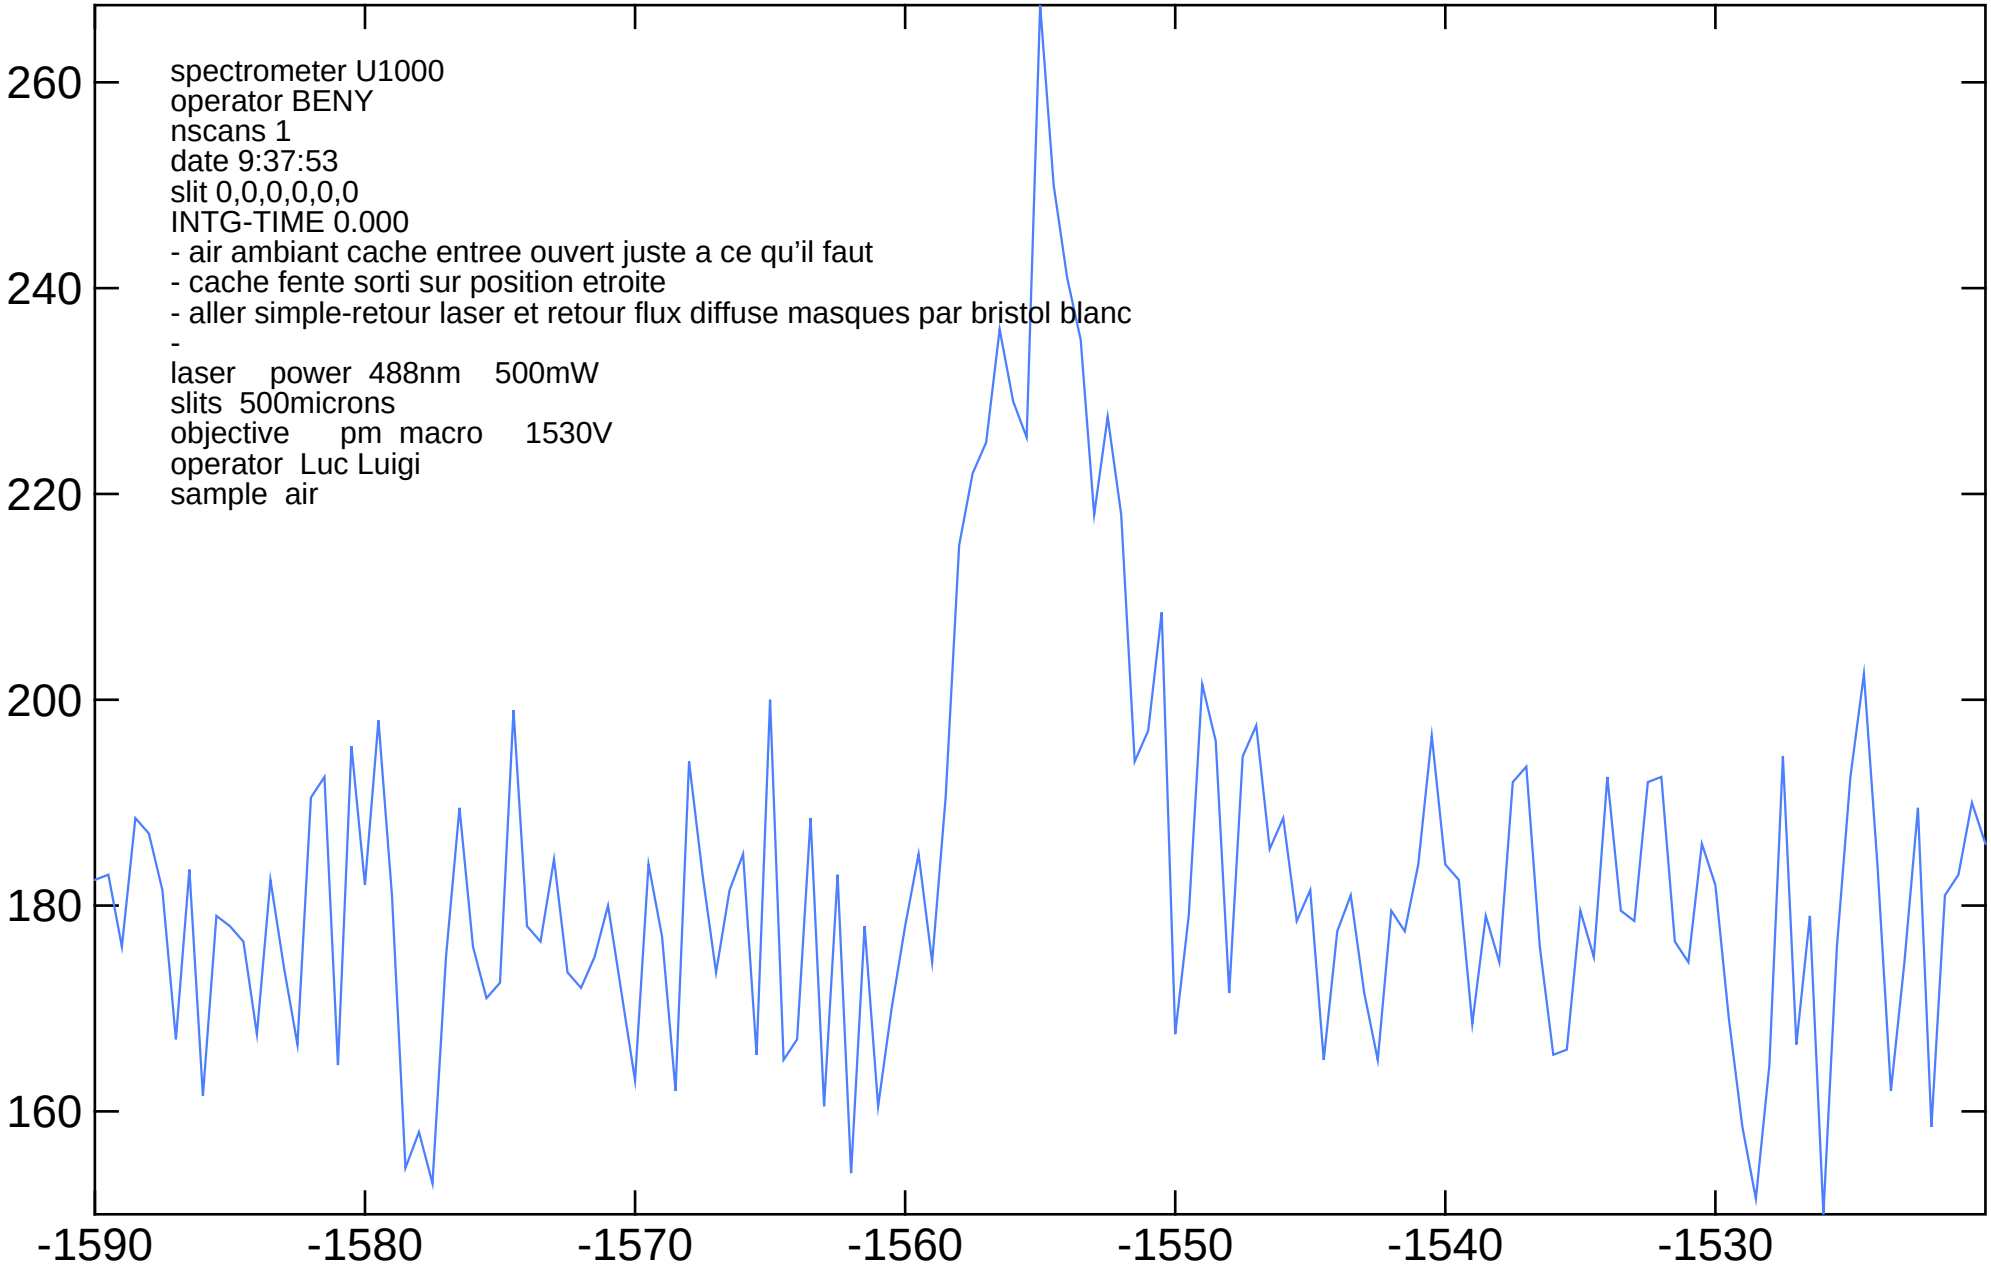
spectrometer U1000
operator BENY
nscans 1
date 9:37:53
slit 0,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- air ambiant cache entree ouvert juste a ce qu'il faut
- cache fente sorti sur position etroite
- aller simple-retour laser et retour flux diffuse masques par bristol blanc
-
laser power 488nm 500mW
slits 500microns
objective pm macro 1530V
operator Luc Luigi
sample air
260
240
220
200
180
160
-1590
-1580
-1570
-1560
-1550
-1540
-1530

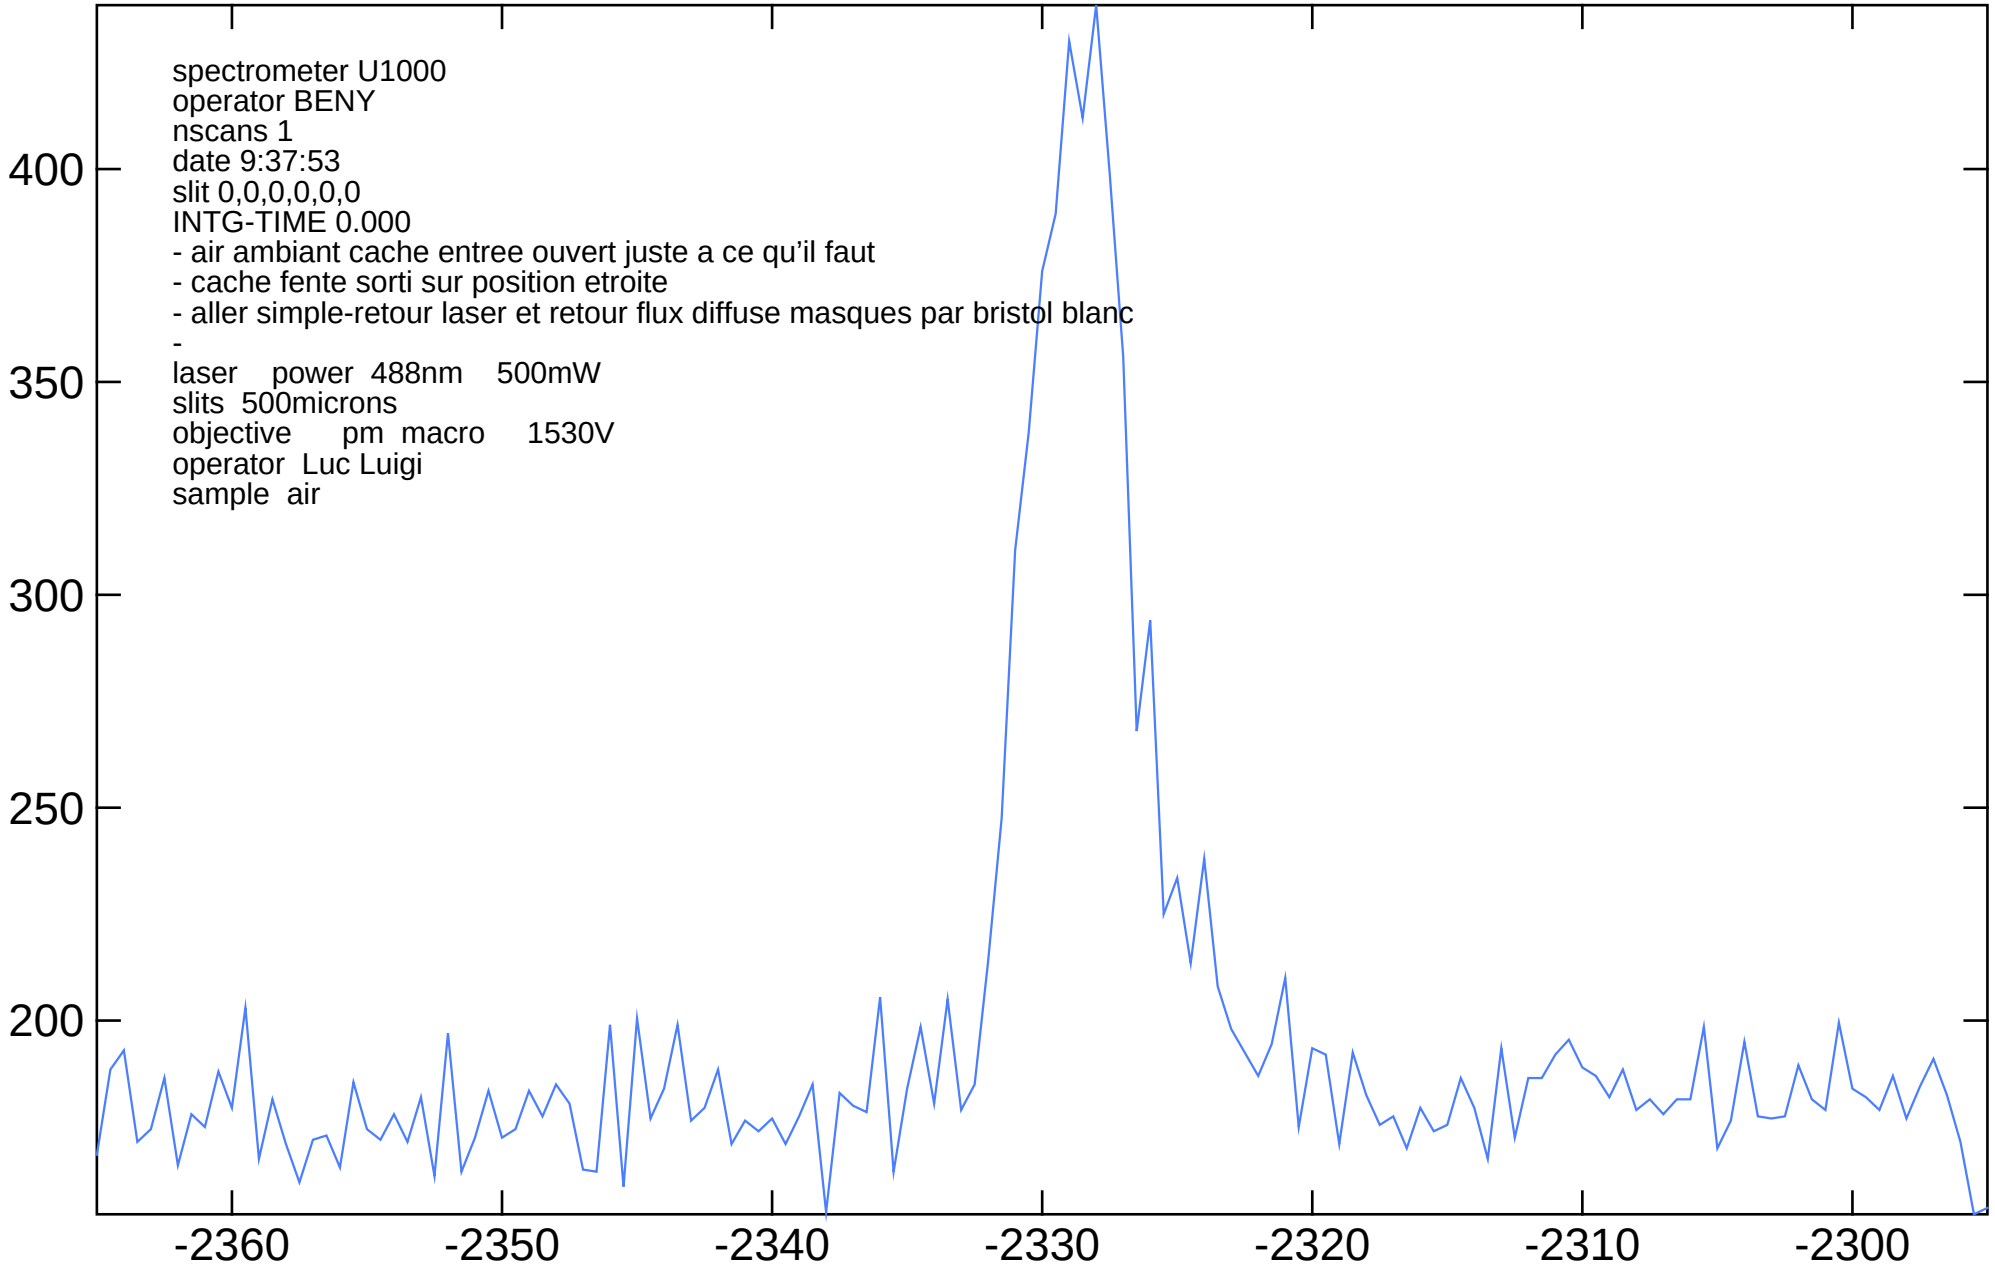
spectrometer U1000
operator BENY
nscans 1
date 9:37:53
slit 0,0,0,0,0,0
INTG-TIME 0.000
- air ambiant cache entree ouvert juste a ce qu'il faut
- cache fente sorti sur position etroite
- aller simple-retour laser et retour flux diffuse masques par bristol blanc
-
laser power 488nm 500mW
slits 500microns
objective pm macro 1530V
operator Luc Luigi
sample air
400
350
300
250
200
-2360
-2350
-2340
-2330
-2320
-2310
-2300